



Litueche
para todos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE SALUD

DECRETO ALCALDICIO No. 000437
LITUECHE, 11 5 MAR 2017

CONSIDERANDO:

- La necesidad de ejecutar los Programas Odontológicos, establecidos en los convenios entre el Servicio de Salud de O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Litueche 2017.
- La necesidad de contratar los servicios de **mantención y reparación de equipos dentales** para mantener en buen estado los equipos dentales pertenecientes a Box dental Litueche, Quelentaro, Pulín y Centro de Salud Litueche.
- Que se necesita mantener los equipos dentales en óptimas condiciones para una buena ejecución de los programas y entregar continuidad del servicio por la alta demanda de pacientes que se atienden en nuestros establecimientos.
- Que este proceso debe realizarse a través del portal de contratación y adquisiciones públicas, **mercado público**.

VISTOS:

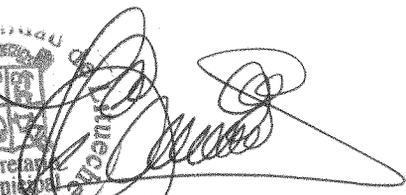
Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 1.550, de fecha 06 de Diciembre del 2016.-. Lo dispuesto en el art. 66 de la Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente. Lo consagrado en el estatuto de atención primaria. Ley 19.378.

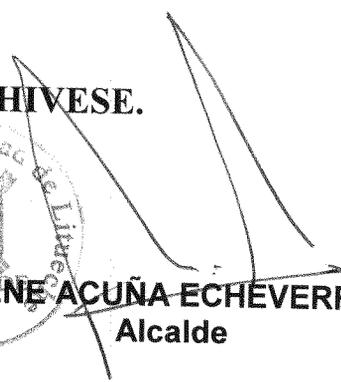
DECRETO:

1. **Llámesese** a licitación pública para Contrato de Suministro de Mantención y Reparación de Equipos Dentales para la mantención de los Box Dentales Litueche, Pulín, Quelentaro y nuevo Centro de Salud Municipal según especificaciones establecidas en las bases administrativas y técnicas de la presente licitación. Se deja establecido que este es un contrato a suma alzada por compra de servicios.
2. **Impútese** el gasto a los Programas Odontológicos año 2017 y el Presupuesto del Área de Salud Municipal vigente.
3. **Nómbrese** en la comisión evaluadora a los siguientes Funcionarios:

Odontóloga DSM, EDF
Odontóloga JUNAEB
Matrón DSM
Enfermera DSM


ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


LAURA URIBE SILVA
Secretario Municipal


RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
Alcalde

RAE/LUS/RPV/GRV/vmy

Distribución
DSM
Oficina de Partes



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE SALUD

BASES DE CONTRATO SUMINISTRO MANTENCIÓN DE EQUIPOS DENTALES

1.- GENERALIDADES

La Municipalidad de Litueche a través del Departamento de Salud Municipal invita a los proveedores inscritos en el portal Chile compra y que tengan relación con el rubro de Mantenición y reparación de equipos médicos y dentales, a participar de la presente licitación.

2.- MANDANTE

I. Municipalidad de Litueche, Departamento de Salud

3.- PUBLICACION

Realizada a través del Portal www.chilecompra.cl

4.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Con recursos de los Programas Odontológicos año 2017 y el Presupuesto del Área de Salud Municipal vigente.

5.- DE LOS OFERENTES PARTICIPANTES

Podrán participar en la presente licitación aquellos oferentes que cumplan con los siguientes requisitos:

- Personas naturales.
- Encontrarse inscrito en los registros de proveedores del portal chilecompra.
- Poseer experiencia certificada en mantención y reparación de equipos dentales.
- Llenar y adjuntar a la oferta los formularios 1-2 y 3.-

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	50%
	20%
	30%

Experiencia certificada se otorgarán 50% a los oferentes que demuestren mediante sus registros de experiencia en mantención y reparación de equipos dentales:
- Mayor a 15 años = 50%
- de 10 a 14 años = 30%
- Menor a 10 años = 10%

Garantía del servicio se otorgarán 20% a los oferentes que se entreguen la mayor garantía de garantía del servicio:
- Mayor a 6 meses = 20%
- de 3 a 5 meses = 10%
- Menor a 3 meses = 0%

Se otorgará a los oferentes que entreguen el precio menor por el servicio requerido.

$$X = \text{Precio mínimo ofertado} * 100 / \text{Precio Oferta X.}$$



* **Puntaje mínimo de adjudicación, 60 puntos**

* **Desempate:** Habiendo empate se adjudicará al oferente que tenga mayor experiencia en mantención y reparación de equipos dentales.
De persistir el empate se adjudicará al oferente que tenga más cercanía geográfica a la región de O'Higgins con el fin de acelerar la mantención y reparación por continuidad de servicio.

7.- DURACIÓN DE CONTRATO

La fecha de inicio de este será la fecha de suscripción del contrato y se extenderá hasta el 31 de Diciembre del año 2017.

8.- NUMERO DE PROPUESTAS

Cada oferente, que desee participar en la licitación, podrá presentar una sola propuesta.

9.- PRESENTACIÓN, APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

Se establece que la forma de presentación de las ofertas será mediante el portal Chilecompra.

La apertura de las ofertas será en forma electrónica.

La adjudicación será mediante resolución de Alcaldía publicada en el portal.

La oferta deberá considerar valores netos unitarios, en pesos chilenos.
Los prestadores deberán informar el % de impuesto que tributan (10%)

10.- OPERATORIA

El requerimiento de las prestaciones serán encausados a través del Departamento de Salud de acuerdo a la siguiente operatoria:

- Solo el Departamento de Salud emitirá las Ordenes de Compra, a través del portal las cuales deben indicar fecha, producto y cantidad de este que se esta solicitando, valor según propuesta del proveedor.
- Para generar los estados de pago el proveedor deberá presentar los siguientes documentos: boleta, orden de compra, recepción conforme de parte de la dirección de salud.

11.- PRESTACIONES

1. Instalación de equipos dentales que se requieran en Centro de Salud Municipal Litueche.
2. Mantención y reparación de Equipos Dentales de Centro de Salud Litueche, Box Dental Litueche, Box Dental Quelentaro y Box Dental Pulín de los siguientes Equipos:

	<u>Box Litueche</u>	<u>Box Quelentaro</u>	<u>Box Pulín</u>	<u>Box Centro de Salud</u>
Sillón Dental	SINOL	KAVO UNIK	KAVO UNIK	KAVO UNIK
Autoclave	GNATUS	TRIDENT MEDICAL	TRIDENT MEDICAL	CLINTEC RITTER
Selladora	CILA	RUNYES	RUNYES	BIOART
Compresor	CILA	SCHULZ	VICDENT JW-	SCHULZ



	DYNAIR		032B	
Ultrasonido	DTE D1	DTE D1	DTE D1	CAVITRON
Equipo de Rayos X	BELMONTT	-	-	FOCUS
Reveladora	No registra	-	-	PERIOMAT PLUS
Turbina	NSK	NSK	NSK	W&H
	W&H	W&H	W&H	
Contra ángulo	NSK	NSK	NSK	W&H
	W&H	W&H	W&H	
Pieza de Mano	NSK	NSK	NSK	W&H
	W&H	W&H	W&H	
Micromotor	NSK	NSK	NSK	W&H
	W&H	W&H	W&H	
Lámpara de Fotocurado	DTE	DTE	DTE	COLTOLUX
				COLTENE

Las prestaciones que se requiere incluyen:

SILLON DENTAL	MANTENCIÓN PREVENTIVA	Revisión de estabilidad en la tensión de alimentación.
		Verificación de la tensión en tierra de red eléctrica según norma vigente.
		Ajuste de punto de parada de motores de subida y bajada.
		Ajuste de posiciones de trabajo.
		Calibración de intensidad de luz de reflector.
		Nivelación de Brazo horizontal y bracket.
		Ajuste de freno y para movimientos giratorio del brazo neumático.
		Verificación de altura mesa.
		Ajuste movimiento brazo de reflector.
		Revisión y ajuste de la presión estática y dinámica de la entrada de aire.
		Revisión de la presión estática de la entrada de agua.
		Revisión y ajuste de la presión estática del aire despresurizado.
		Revisión de eficiencia eyectores.
		Revisión y ajuste del sistema para llenado de vaso.
		Revisión y ajuste de la presión de aire para propulsión de instrumentos rotatorios.
		Ajuste de flujo de agua y aire para jeringa de bracket y brazo auxiliar.
		Ajuste de volumen de agua y aire para spray de instrumentos rotatorios.
		Inspección de puntos de fijación para sillón al piso, fijación para tapiz, conexiones a red de agua aire y desagüe.
Revisión de pulsadores y funcionalidad integral del pedal.		
Cambio Ampolleta reflector		

	REPARACIÓN	Cambio de Boquilla eyector Cambio de Boquilla Hemosuctor Cambio de Rejilla Cambio de Filtro de salivera Cambio de Válvula UNIK Cambio de Válvula Celeste Cambio de Conexión Turbina y Micromotor. Cambio de Manguera de eyector Cambio de Manguera Hemosuctor Cambio de Manguera de Turbina y Micromotor. Cambio de Manguera de Desagüe. Cambio de Manguera de aire. Cambio de Tarjeta de Comando				
COMPRESOR	MANTENCIÓN PREVENTIVA	Revisión de cabezales de motores compresores. Chequeo y limpieza de válvulas contrarretorno y válvula de alivio. Revisión de motor eléctrico y consumo (amp). Revisión de Presostato y rangos de trabajo. Chequeo regulador con filtro y presión de entrada de aire a sillón dental. Revisión de válvula de seguridad de sobrepresión de aire.				
		Chequeo de térmicos de sobrettemperatura de motor. Control de funcionamiento y puesta en servicio.				
		REPARACIÓN	Cambio Filtro de aire Cambio de Válvula Despiche Cambio Unidad Compresora Cambio de Presostato Cambio de Regulador con Filtro			
			MANTENCIÓN PREVENTIVA	Limpieza integral interna y externa de equipo Chequeo de calefactores y control de consumo (amp). Revisión de cable de alimentación, conector portafusiles, conexión a tierra y demás componentes. Desalinizado de estanque cámara interna. Revisión de circuito electrónico de placa comando y control. Revisión de sello puerta, válvula de vacío y sobrepresión. Chequeo y prueba accionamiento válvula de seguridad. Revisión y limpieza de válvulas solenoides y filtros. Revisión y mantención bombas de vacío. Limpieza de estanque agua limpia y usada. Chequeo y control de presión, temperatura y ciclo esterilizado programado.		
				REPARACIÓN	Cambio de Sello puerta Cambio de Válvulas de Vacío Cambio de Válvulas de presión Cambio de Tarjeta Cambio de Calefactor Cambio de electroválvula de descarga de Vapor	
					MANTENCIÓN	Cambio de Pieza de Mano de ultrasonido Cambio Válvula de suministro de agua
						MANTENCIÓN

EQUIPO DE RAYOS X	MANTENCIÓN	Verificación de la tensión en tierra de red eléctrica según norma vigente.
		Revisión y nivelación de Brazo horizontal
		Ajuste de freno para movimientos giratorios y tijeras.
		Ajuste de Tensor de posicionador de cabezal.
		Revisión de conectores, contactos eléctricos cables de señal.
		Revisión de tablero táctil de control maestro principal.
		Revisión de cabezal de radiación.
		Revisión y ajuste de soporte pared y nivelación.
		Revisión de disparador y pruebas de rayos x

12.- REPUESTOS E INSUMOS:

Los repuestos e insumos serán de cargo del prestador.

13.- ENTREGA DE LAS PRESTACIONES

Estas deberán ser realizadas en Box dental Litueche, centro de Salud Municipal Litueche, Posta de Salud Rural Quelentaro y Pulín.

14.- SERVICIOS ADICIONALES

En caso de que el proveedor ofrezca servicios adicionales, éstos deberán ser claramente especificados en la oferta.

15.- CAUSALES DE TÉRMINO DE CONTRATO

- Incumplimiento en los plazos señalados.-
- Finalización del contrato por acuerdo entre la Municipalidad y el Proveedor Adjudicado con mínimo 15 días de anticipación.
- El término de contrato no considera indemnización de ninguna índole por parte del Municipio.

19.- Declaración Jurada

- A través de Declaración Jurada dar cumplimiento a los siguientes artículos:

Artículo 10º de la ley 18.883.

Artículo 55º, 56º y 57º de la Ley Nº 18.575.



RENÉ ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE DE LITUECHE



FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

FECHA: _____

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE		
RUT		
DOMICILIO DEL PROPONENTE	CALLE:	N°:
	DEPTO.:	
	COMUNA:	CIUDAD:
	FONO:	FAX
	E-MAIL:	

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE



FORMATO N° 2
DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL MERCADOPUBLICO

FECHA: _____

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE		
RUT		
DOMICILIO DEL PROPONENTE	CALLE:	N°:
	DEPTO.:	
	COMUNA:	CIUDAD:
	FONO:	FAX
	E-MAIL:	

B. DECLARO LO SIGUIENTE:

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas generales, bases técnicas especiales y especificaciones técnicas.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre los requerimientos y especificaciones técnicas de la propuesta.
3. Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
4. Estar conforme con las condiciones generales del programa, incluidas las observaciones y aclaraciones si las hubiere.
5. Aceptar la decisión del mandante en la adjudicación de la propuesta en el sentido que es inapelable y no susceptible de recursos administrativos o judiciales alguno.
6. Que el incumplimiento de las condiciones que establecen las bases Administrativas, dará pie a un término anticipado de contrato.
7. Que no se me ha rescindido ningún contrato por parte del Fisco o con particulares, por incumplimiento.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



OFERTA ECONÓMICA TOTAL

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE	
RUT	

B. DETALLE DE PROPUESTA

Detallar Valores más IMPUESTO 10%

SILLON DENTAL	MANTENCIÓN PREVENTIVA	Revisión de estabilidad en la tensión de alimentación.	\$
		Verificación de la tensión en tierra de red eléctrica según norma vigente.	
		Ajuste de punto de parada de motores de subida y bajada.	
		Ajuste de posiciones de trabajo.	
		Calibración de intensidad de luz de reflector.	
		Nivelación de Brazo horizontal y bracket.	
		Ajuste de freno y para movimientos giratorio del brazo neumático.	
		Verificación de altura mesa.	
		Ajuste movimiento brazo de reflector.	
		Revisión y ajuste de la presión estática y dinámica de la entrada de aire.	
		Revisión de la presión estática de la entrada de agua.	
		Revisión y ajuste de la presión estática del aire despresurizado.	
		Revisión de eficiencia eyectores.	
		Revisión y ajuste del sistema para llenado de vaso.	
		Revisión y ajuste de la presión de aire para propulsión de instrumentos rotatorios.	
		Ajuste de flujo de agua y aire para jeringa de bracket y brazo auxiliar.	
		Ajuste de volumen de agua y aire para spray de instrumentos rotatorios.	
		Inspección de puntos de fijación para sillón al piso, fijación para tapiz, conexiones a red de agua aire y desagüe.	
	Revisión de pulsadores y funcionalidad integral del pedal.		
	REPARACIÓN	Cambio Ampolleta reflector	\$
		Cambio de Boquilla eyector	\$
		Cambio de Boquilla Hemosuctor	\$
		Cambio de Rejilla	\$
Cambio de Filtro de salivera		\$	
Cambio de Válvula UNIK		\$	
Cambio de Válvula Celeste		\$	
Cambio de Conexión Turbina y Micromotor.	\$		
Cambio de Manguera de eyector	\$		



		Cambio de Manguera Hemosuctor	\$
		Cambio de Manguera de Turbina y Micromotor.	\$
		Cambio de Manguera de Desagüe.	\$
		Cambio de Manguera de aire.	\$
		Cambio de Tarjeta de Comando	\$
COMPRESOR	MANTENCIÓN PREVENTIVA	Revisión de cabezales de motores compresores.	\$
		Chequeo y limpieza de válvulas contraretorno y válvula de alivio.	
		Revisión de motor eléctrico y consumo (amp).	
		Revisión de Presostato y rangos de trabajo.	
		Chequeo regulador con filtro y presión de entrada de aire a sillón dental.	
		Revisión de válvula de seguridad de sobrepresión de aire.	
		Chequeo de térmicos de sobrettemperatura de motor.	
		Control de funcionamiento y puesta en servicio.	
	REPARACIÓN	Cambio Filtro de aire	\$
		Cambio de Válvula Despiche	\$
		Cambio Unidad Compresora	\$
		Cambio de Presostato	\$
		Cambio de Regulador con Filtro	\$
	AUTOCLAVE	MANTENCIÓN PREVENTIVA	Limpieza integral interna y externa de equipo
Chequeo de calefactores y control de consumo (amp).			
Revisión de cable de alimentación, conector portafusibles, conexión a tierra y demás componentes.			
Desalinizado de estanque cámara interna.			
Revisión de circuito electrónico de placa comando y control.			
Revisión de sello puerta, válvula de vacío y sobrepresión.			
Chequeo y prueba accionamiento válvula de seguridad.			
Revisión y limpieza de válvulas solenoides y filtros.			
Revisión y mantención bombas de vacío.			
Limpieza de estanque agua limpia y usada.			
Chequeo y control de presión, temperatura y ciclo esterilizado programado.			
REPARACIÓN		Cambio de Sello puerta	\$
		Cambio de Válvulas de Vacío	\$
		Cambio de Válvulas de presión	\$
	Cambio de Tarjeta	\$	
	Cambio de Calefactor	\$	
	Cambio de electroválvula de descarga de Vapor	\$	
ULTRASONIDO	MANTENCIÓN	Cambio de Pieza de Mano de ultrasonido	\$
		Cambio Válvula de suministro de agua	\$
LAMPARA FOTOCURADO	MANTENCIÓN	Revisión, medición de Longitud de Onda.	\$
		Cambio de fibra óptica	\$
EQUIPO DE RAYOS X	MANTENCIÓN	Revisión de estabilidad en la tensión de alimentación.	\$
		Verificación de la tensión en tierra de red eléctrica según norma vigente.	
		Revisión y nivelación de Brazo horizontal	
		Ajuste de freno para movimientos giratorios y tijeras.	
		Ajuste de Tensor de posicionador de cabezal.	

		Revisión de conectores, contactos eléctricos cables de señal.	
		Revisión de tablero táctil de control maestro principal.	
		Revisión de cabezal de radiación.	
		Revisión y ajuste de soporte pared y nivelación.	
		Revisión de disparador y pruebas de rayos x	

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

